

Ультразвуковая эхография (B-Scan)



Физика

Акустика

Ультразвук

Биология

Современные методы обработки изображений

Прикладные науки

Инженерные
специальностиНеразрушающий
контроль (НРА)Ультразвуковое
исследование

Прикладные науки

Медицина

Радиология и ультразвуковая
диагностика

Ультразвуковая томография



Уровень сложности

твердый



Размер группы

2



Время подготовки

10 Минут



Время выполнения

45+ Минут

PHYWE
excellence in science

Общая информация

Описание

PHYWE
excellence in science

Рис. 1: Оборудование для ультразвуковой эхографии, экспериментальная установка

Ультрасонография или В-сканирование является важным вспомогательным средством для клинической оценки различных заболеваний глаз. Зная показания к ультразвуковому исследованию и правильную технику обследования, можно собрать огромный объем информации, который невозможно получить только при клиническом обследовании.

Дополнительная информация (1/3)

PHYWE
excellence in science

предварительные знания



Ультразвук - это звуковые волны с частотами, которые выше, чем те, которые слышит человек (> 20 000 Гц). Ультразвуковые изображения, также известные как сонограммы, создаются путем отправки импульсов ультразвука в ткань с помощью зонда. Ультразвуковые импульсы отражаются от тканей с различными отражательными свойствами и записываются и отображаются в виде изображения.

Научный принцип



Основные принципы создания ультразвуковых изображений В-сканирования (яркое представление амплитуд отражения) демонстрируются с помощью простого исследуемого блока. Эксперимент выполняется с помощью ультразвукового эхоскопа в эхо-импульсном режиме, а сканирование объекта производится вручную. Затем оценивается качество изображения и наиболее важные дефекты изображения.

Дополнительная информация (2/3)

PHYWE
excellence in science

Цель обучения



Учащиеся должны узнать о распространении ультразвуковых волн, времени пролета, амплитуде эхо-сигнала, коэффициенте отражения, А-сканировании, обнаружении дефектов, неразрушающем контроле (NDT), ультразвуковом приемопередатчике

Примечание

Обратите внимание на инструкции по эксплуатации и технике безопасности, приведенные в руководстве по эксплуатации ультразвукового эхоскопа.

Дополнительная информация (3/3)

PHYWE
excellence in science

Задачи



1. Измерьте штангенциркулем 3 длины кромки исследуемого блока и определите время распространения звука для различных длин кромок блока с помощью программного обеспечения для измерения.
2. Рассчитайте скорость звука в материале исследуемого блока и переключите программное обеспечение для измерения (режим А-сканирования) на измерение глубины
3. С помощью программного обеспечения для измерений (режим В-сканирования) выполните два В-сканирования, одно с зондом на 1 МГц, другое с зондом 2 МГц.
4. Измерьте глубину и ширину эхо-сигналов на полученных изображениях.
5. Охарактеризуйте качество изображений с точки зрения их разрешения и дефектов.

Инструкции по технике безопасности

PHYWE
excellence in science

- Для этого эксперимента применяются общие инструкции по безопасному проведению экспериментов при преподавании естественных наук.
- Перед запуском установки внимательно прочтите прилагаемую инструкцию по эксплуатации. Убедитесь, что все инструкции по технике безопасности, перечисленные в инструкции по эксплуатации, строго выполняются при запуске устройства.
- Используйте устройство только по прямому назначению.
- Беременные женщины, а также люди с кардиостимуляторами должны находиться на расстоянии не менее 1 м от магнита.

Теория (1/4)

Известная длина (s) материала и измеренное время прохождения (t) ультразвуковой волны могут быть использованы для определения скорости звука c с помощью уравнения (1):

$$c = \frac{2s}{t} \quad (\text{двойная длина в случае измерения отражения}) \quad (1)$$

Большинство ультразвуковых зондов имеют соединительный и защитный слой (согласующий слой) перед пьезокерамическим элементом. Этот слой приводит к ошибке измерения при определении скорости звука. Это означает, что измеренное время прохождения (t) включает время прохождения в связующем слое t_L , а также в образце t_S

Эту погрешность можно устранить, используя разность между двумя измерениями одного и того же материала с разной длиной s_1 и s_2 (уравнение (2)).

Теория (2/4)

$$c = \frac{2(s_1 - s_2)}{t_1 - t_2} = \frac{2(s_1 - s_2)}{(t_{s_1} + t_L) - (t_{s_2} + t_L)} = \frac{2(s_1 - s_2)}{t_{s_1} - t_{s_2}} \quad (2)$$

На частичном ультразвуковом изображении (B-сканирование) амплитуда эхо-сигнала отображается как значение шкалы серого, а время прохождения - как глубина проникновения. Строка из нескольких смежных линий глубины приводит к изображению сечения. Для этого зонд необходимо перемещать в продольном направлении по области исследования. Локальное разрешение вдоль этой линии сканирования зависит от положения зонда или скорости его движения. Простой способ получить изображение в разрезе - медленно перемещать зонд вручную. Однако в этом случае точное поперечное разрешение возможно только с помощью дополнительных систем сбора координат, таких как линейные сканеры. С другой стороны, благодаря низкой скорости сканирования можно получать высококачественные изображения на расширенных участках исследования.

Теория (3/4)

Качество изображения определяется следующими параметрами:

- Точная передача точек изображения на основе координат (система сканирования)
- Осевое разрешение (частота ультразвука)
- Боковое разрешение (частота звука, геометрия звукового поля и фокус)
- Разрешение по шкале серого (мощность передачи, коэффициент усиления и ТГК).
- Количество строк (скорость сканирования)
- Аберрации (акустические тени, множественные отражения и артефакты движения).

Теория (4/4)

Фокусная область зонда x поршневого типа определяется геометрией зонда (радиус R) и длиной волны ультразвуковой волны λ в материале со скоростью звука c на частоте волны f :

$$x = \frac{R^2}{\lambda} \quad (4) \quad \lambda = \frac{c}{f} \quad (3)$$

Оборудование

Позиция	Материал	Пункт No.	Количество
1	Базовый набор "Ультразвуковая эхография II "	13924-99	1
2	Штангенциркуль с нониусом	03010-00	1
3	Линейка, пластмассовая, 200 мм	09937-01	1



Подготовка и выполнение работы

Подготовка и выполнение работы (1/14)

Базовый комплект "Ультразвуковой эхоскоп II" состоит из контроллера ультразвукового эхоскопа, который подключается к компьютеру через интерфейс USB, ультразвуковых зондов (1 МГц и 2 МГц), ультразвукового исследуемого блока, набора ультразвуковых цилиндров, ультразвуковых текстовых пластин, геля для ультразвуковой эхоскопии и программного обеспечения для эхоскопии для Windows.

На рисунке 1 показана схема проведения эксперимента.

Блок УЗИ:

На следующем рисунке (рис. 2) показан технический чертеж ультразвукового исследуемого блока с его номинальными размерами.

Для облегчения связи на рисунке 3 указаны номера отдельных дефектов (отверстий) и обозначения расстояний измерения:

Подготовка и выполнение работы (2/14)

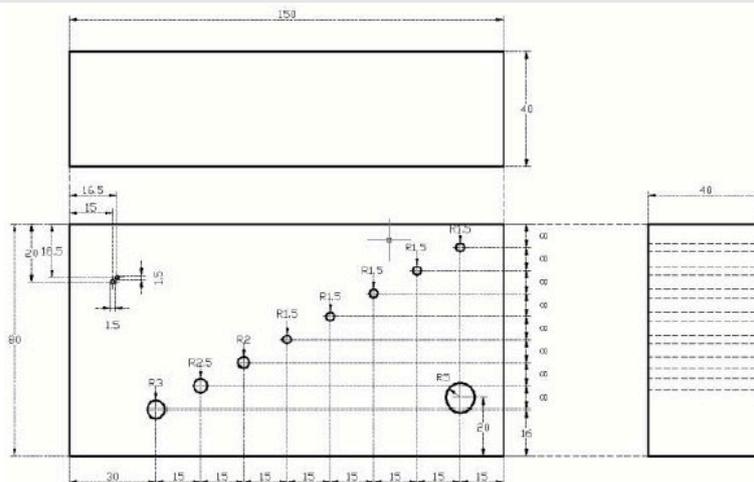


Рис. 2: Технический чертеж исследуемого блока ультразвукового контроля

Подготовка и выполнение работы (3/14)

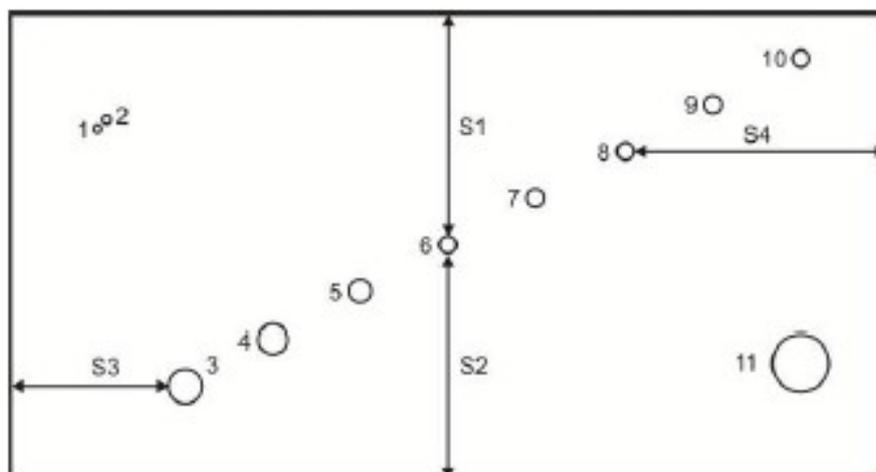


Рис.3: Названия дефектов (отверстий) и расстояния измерения

Подготовка и выполнение работы (4/14)

PHYWE
excellence in science

Рекомендации по применению геля для УЗИ:

Несмотря на то, что гель для ультразвука очень эффективен в этом эксперименте, мы рекомендуем использовать вместо него воду, поскольку её легче использовать во время эксперимента и удалять после него. Нанесите водяную пленку на поверхность исследуемого блока. Это даже полезно при проведении сканирования (т.е. если зонд должен постоянно перемещаться по поверхности блока).

Внимание: Если Вы предпочитаете работать с гелем для УЗИ, протрите ультразвуковой исследуемый блок и ультразвуковые зонды сразу после их использования в комбинации с гелем. Затем промойте их водой или мыльным раствором. Для очистки оборудования не используйте спирт или жидкости с растворителями. Избегайте механических повреждений поверхности (царапин и т.д.), так как это может негативно сказаться на контакте.

Пожалуйста, действуйте следующим образом:

Подготовка и выполнение работы (5/14)

PHYWE
excellence in science

Подключение оборудования

Подключите ультразвуковой эхоскоп к свободному USB-порту вашего компьютера с помощью USB-кабеля. Если программное обеспечение установлено правильно, устройство будет автоматически идентифицировано.

Подключите ультразвуковые зонды (1 МГц или 2 МГц) ко входу "Отражение". Для импульсных эхо-измерений переключатель должен быть установлен в положение "Отражение".

Нанесите на исследуемый блок тонкую водяную пленку.

Внимание: Не используйте слишком много воды для соединения, так как она может протечь под блок и изменить сигнал отражения нижнего эхо (звук будет выведен на поверхность под блоком) (таблица).

Подготовка и выполнение работы (6/14)

PHYWE
excellence in science

Программное обеспечение

Программное обеспечение используется для записи, отображения и оценки данных. После запуска программного обеспечения устройство и интерфейс будут идентифицированы автоматически. Отобразится главный экран с сигналом А-сканирования в верхней части и TGC в нижней части. Также будут отображаться частота приемника и настройки устройства (усиление, мощность передачи, отражение / передача). Курсоры измерения можно перемещать с помощью мыши, после чего можно считывать амплитуду и время прохождения. Все остальные настройки доступны через меню или с помощью кнопок в интерфейсе программы.

Внимание: Соблюдайте, пожалуйста, специальные инструкции по эксплуатации и технике безопасности, содержащиеся в инструкциях по эксплуатации ультразвукового эхоскопа.

Подготовка и выполнение работы (7/14)

PHYWE
excellence in science

Проведение эксперимента

Чтобы определить скорость звука в материале исследуемого блока, необходимо измерить длину всех кромок штангенциркулем. Затем подведите ультразвуковой зонд к блоку с помощью небольшого количества воды или геля для ультразвука. Сделайте это в месте с как можно меньшим количеством дефектов (отверстий). Определите время прохождения до противоположной поверхности объекта в режиме А-сканирования. Установите усиление, включая TGC и мощность передачи, чтобы эхо можно было обнаружить без проблем (см. Рис. 4-6). На больших расстояниях следует выбирать более высокое усиление из-за сильного затухания. Во время измерения длинной стороны А-сканирование всегда будет включать в себя эхо-сигналы от отверстий (рис. 6). Нижний эхо-сигнал (отражение на противоположной стороне) можно легко идентифицировать, перемещая зонд, поскольку он сохраняет свое положение при А-сканировании.

Подготовка и выполнение работы (8/14)

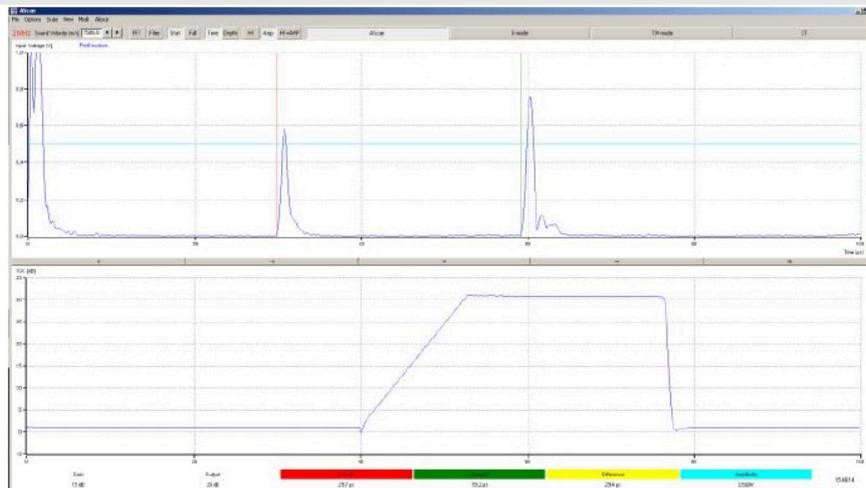
PHYWE
excellence in science

Рис.4: Сторона 1 с длиной кромки припл. 40 мм

Подготовка и выполнение работы (9/14)

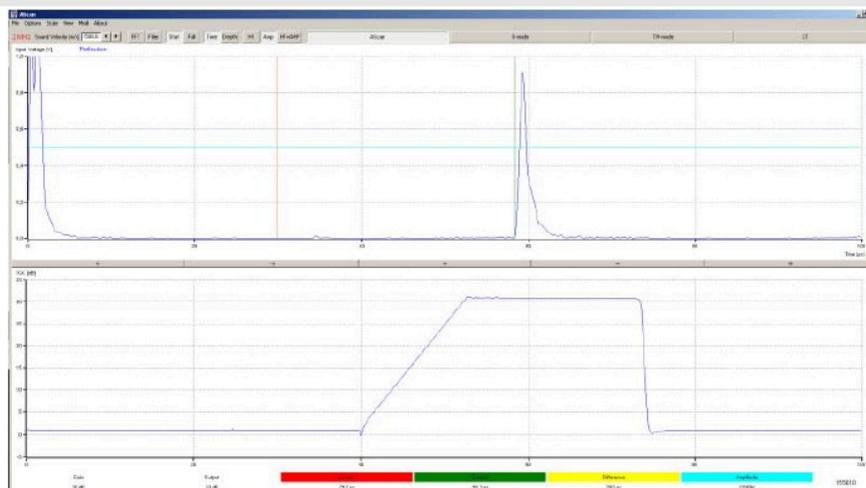
PHYWE
excellence in science

Рис. 5: Сторона 2 с длиной кромки припл. 80 мм

Подготовка и выполнение работы (10/14)

PHYWE
excellence in science

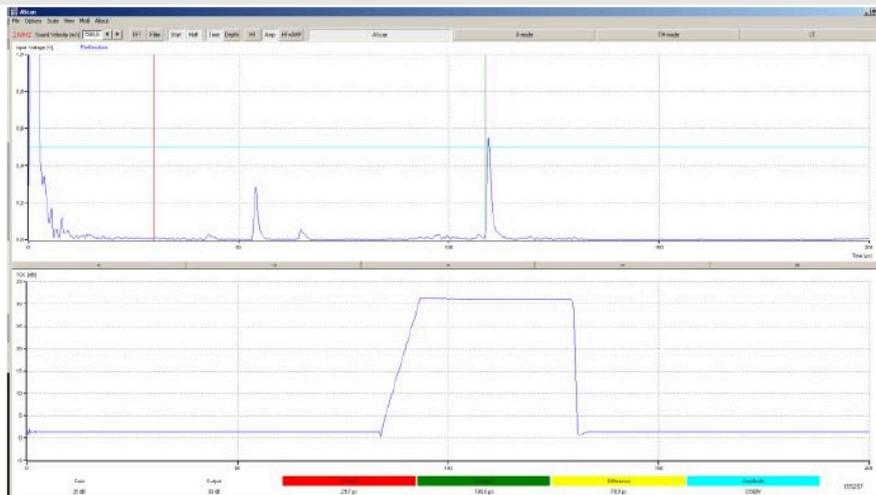


Рис. 6: Сторона 3 с длиной кромки припл. 150 мм

Подготовка и выполнение работы (11/14)

PHYWE
excellence in science

Время прохождения и длины кромок можно использовать в сочетании с уравнением (1) для определения скорости звука в материале исследуемого блока.

Введите это значение в поле "Скорость звука" и переключите программное обеспечение на измерение глубины ("Глубина"). Настройки передачи и приема эхоскопа должны быть выбраны таким образом, чтобы амплитуда сигнала не превышала пределы даже в том случае, если объекты находятся вблизи поверхности. Для этого настройки TGC должны быть изменены (см. рис. 7).

Подготовка и выполнение работы (12/14)

PHYWE
excellence in science

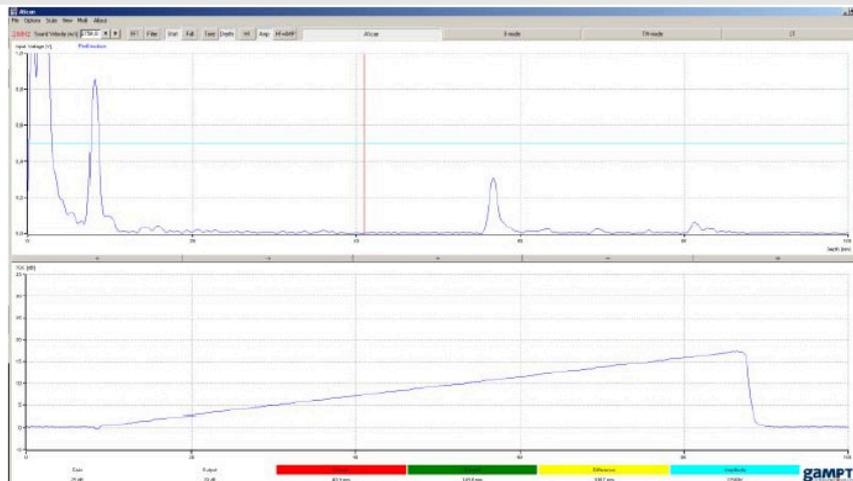


Рис. 7: Настройки программного обеспечения в режиме А-сканирования для ручной записи В-сканирования

Подготовка и выполнение работы (13/14)

PHYWE
excellence in science

Затем нажмите кнопку "В-Режим", чтобы запустить программу для записи двухмерного изображения яркости (В-сканирование, яркость).

Поместите блок на его длинную сторону и поместите зонд 1 МГц к одному из краев исследуемого блока, смоченного небольшим количеством воды. Нажмите кнопку "Старт" в программном обеспечении и плавно перемещайте датчик по блоку.

Когда другой конец исследуемого блока будет достигнут, остановите программное обеспечение (кнопка "Стоп"). Контрастность и яркость записанного В-сканированного изображения могут быть изменены с помощью функций обработки изображения. Расстояние между отверстиями и верхним краем может быть измерено на изображении с помощью курсора (компьютерной мыши).

Повторите измерение с помощью зонда на 2 МГц и сравните качество изображений.

Подготовка и выполнение работы (14/14)

PHYWE
excellence in science



Рис.8: Экран В-режима до начала измерения (с текущим А-сканированием и TGC справа)

Оценка (1/12)

PHYWE
excellence in science

Результаты

В таблице 1 показаны длины кромок, измеренные штангенциркулем, и время прохождения, измеренное с помощью эхоскопа (рис. 4-6).

С помощью этих значений можно использовать уравнение (2) для определения скорости звука в материале.

На основании этих расчетов скорость звука в исследуемом блоке из акрилового стекла составляет 2754 м/с, и это значение принимается во внимание при В-сканировании. В результате с помощью курсора можно измерить отверстия прямо на изображении. В таблице 3 показаны расстояния, измеренные при В-сканировании, в сравнении со значениями, измеренными с помощью штангенциркуля.

Оценка (2/12)

	Длина	Время пролета
	[мм]	[мкс]
s_1	40.6	29.5
s_2	80.0	58.4
s_3	149.2	108.9

Таблица 1: Длины кромок исследуемых объектов и времяпрохождения (пролета)

Оценка (3/12)

Измерение	Скорость звука
	[м/с]
$s_2 - s_1$	2,755
$s_3 - s_1$	2,753
Среднее значение	2,754

Таблица 2: Скорость звука в исследуемом блоке

Оценка (4/12)

На основании этих расчетов скорость звука в блоке из акрилового стекла составляет 2754 м / с, и это значение принимается во внимание при В-сканировании. В результате можно измерять отверстия прямо на изображении с помощью курсора. В таблице 3 показаны расстояния, измеренные при В-сканировании, в сравнении со значениями, измеренными с помощью штангенциркуля.

Измерение штангенциркулем выполняется непосредственно у верхнего края отверстия. Эта точка слишком мала для ультразвуковой волны и поэтому измеряется средний сигнал поверхности отверстия. Осевое разрешение, улучшенное с увеличением частоты, очень хорошо видно. Значения, полученные с помощью зонда на 2 МГц намного ближе к значениям, определенным штангенциркулем.

Комбинированный сложный метод сканирования позволяет представить исследуемый блок с высоким качеством изображения. Поскольку зонд перемещается вручную, артефакты движения являются самой большой проблемой с точки зрения разрешения по горизонтали. На рисунках 9 и 10 показаны изображения В-сканирования, полученные с помощью зонда 1 МГц и зонда 2 МГц соответственно.

Оценка (5/12)

Отверстие	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Глубина (2 МГц), мм	20.5	18.8	62.2	54.7	47.1	39.6	31.7	23.5	15.5	7.8	56
Глубина (2 МГц), мм	-	19.9	62.9	55.3	48	40.5	32.6	24.4	16.4	8.9	57.1
Глубина (штангенциркуль), мм	19.3	17.5	60.8	53.5	45.9	38.3	30.4	22.3	14.3	6.3	54.8

Таблица 3: Расстояния, измеренные при В-сканировании

Оценка (6/12)

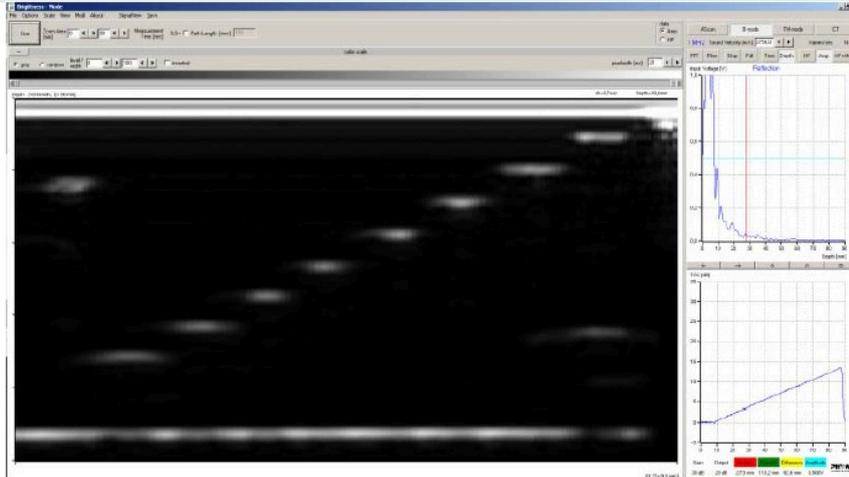
PHYWE
excellence in science

Рис. 9: Изображение В-сканирования, полученное с помощью зонда частотой 1 МГц, время измерения 10 секунд, изображение не обработано.

Оценка (7/12)

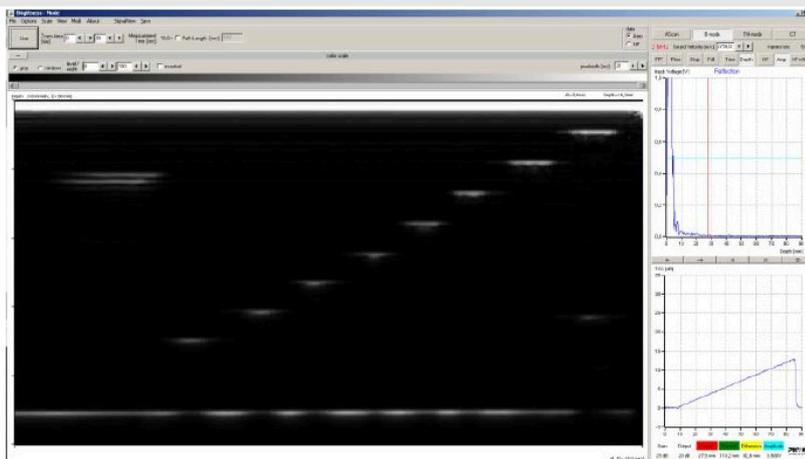
PHYWE
excellence in science

Рис. 10: Изображение В-сканирования, полученное с помощью зонда на 2 МГц, время измерения 10 секунд, изображение не обработано.

Оценка (8/12)

Из 5 верхних отверстий наклонной группы (диаметр отверстия: 3 мм) третье отверстие сверху (отверстие № 8) отображается с наилучшим разрешением по горизонтали, поскольку зона фокусировки зонда с частотой 1 МГц находится примерно на 2,3 см. Зона фокусировки зонда с частотой 2 МГц находится немного глубже, так что в этом случае самое высокое разрешение по горизонтали можно найти в пятом отверстии сверху (отверстие № 6). В таблице 3 приведены несколько значений для оценки зоны фокусировки в соответствии с уравнением (3).

Два маленьких отверстия можно отличить только с помощью зонда на 2 МГц, так как он имеет значительно более высокое осевое разрешение.

Оценка (9/12)

Датчик	Радиус [мм]	Частота [МГц]	Скорость звука [м/с]	Длина волны [мм]	Зона фокусировки [см]
1 МГц	8	1	2,754	2.75	2.3
2 МГц	8	2	2,754	1.38	4.6

Таблица 4: Зона фокусировки датчиков

Оценка (10/12)

PHYWE
excellence in science

Светлое нижнее эхо прерывается несколькими более темными участками, так как дефекты, расположенные над ним, отбрасывают акустическую тень. Измерения, особенно под большим дефектом в правом нижнем углу невозможны.

На рис. 11 показано изображение В-сканирования с измененными настройками контраста. Тот же результат будет обеспечен усилителем с перегрузкой. Отверстие, которое находится ближе всего к поверхности (отверстие № 10), больше не может быть обнаружено в начальном эхо-сигнале зонда.

В случае ручного сканирования, устойчивость движения играет важную роль. Этот метод чувствителен к боковому разрешению и общим ошибкам измерения. На рис. 12 показаны измерения, выполненные с нерегулярной скоростью сканирования. Представление расстояний между отверстиями с правой стороны является неверным.

Оценка (11/12)

PHYWE
excellence in science

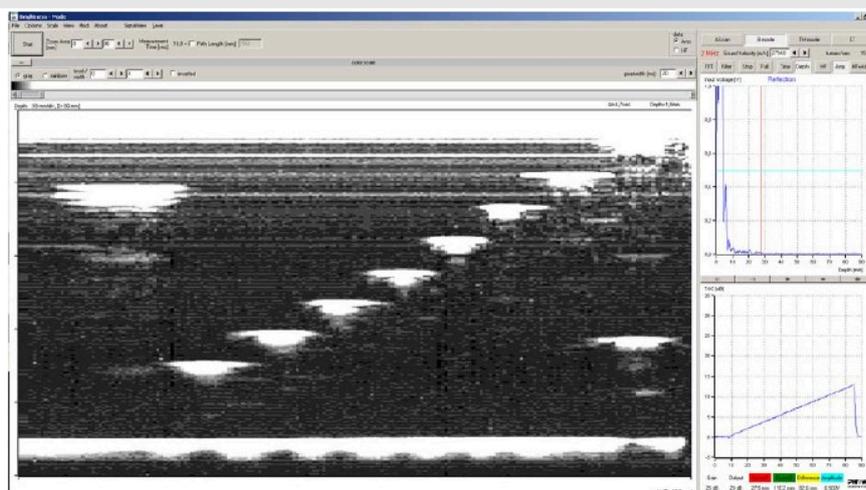


Рис. 11: Изображение В-сканирования с сильно превышающим сигналом

Оценка (12/12)

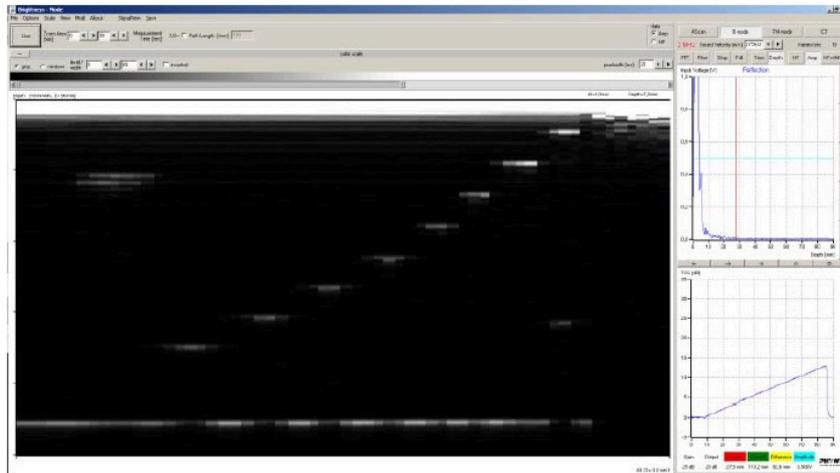
PHYWE
excellence in science

Рис. 12: В-сканированное изображение, полученное при нерегулярном движении датчика.

Оценка (11/11)

PHYWE
excellence in science

Заполните пробелы в тексте

На частичном ультразвуковом изображении (В-сканирование) отображается как значение шкалы серого, а время прохождения(пролета) - как . Строка из нескольких смежных линий глубины приводит к изображению сечения. Для этого зонд необходимо перемещать по области исследования. вдоль этой линии сканирования зависит от положения зонда или скорости его движения.

Проверить

Слайд

Оценка/Всего

Слайд 39: B-Scan

0/4

Общий балл



Показать решения



Вспомнить